Handhörer Modul EE-HS3 für EE 380ACS

Anschluss

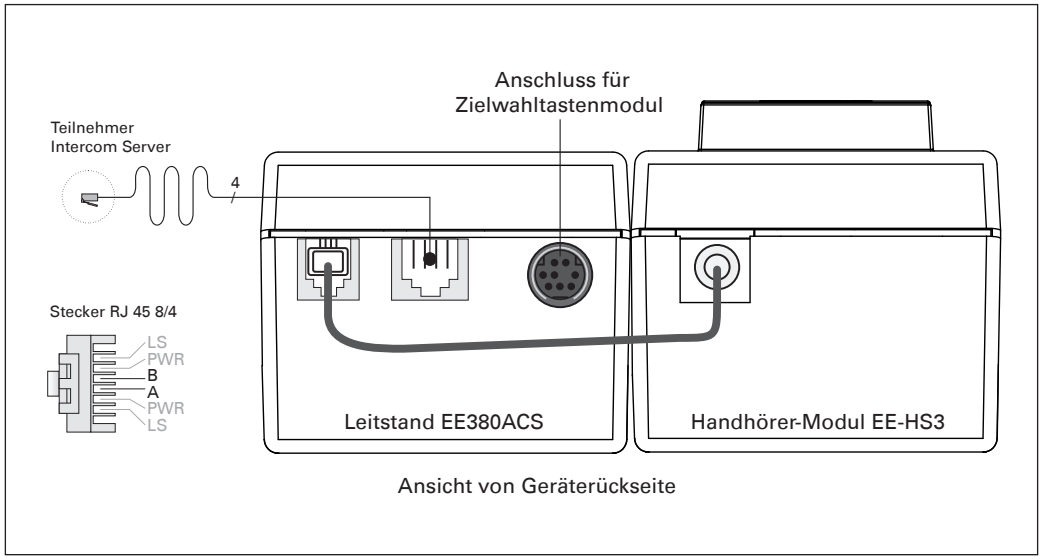

Ansicht von Geräterückseite

Systemanforderungen

- GE 800 / GE 300
- Digitale Teilnehmerkarte G8-GED / G3-GED
- Vollständiger Funktionsumfang (Plug&Play und erweiterte Handhörerfunktionalität) benötigt Leitstand EE 380ACS Rev. AC
- Intercom Server Software min. PRO 800 3.1
- Feature Lizenz 3.x

Achtung

Die im Handhörer EE-HS3 enthaltenen Magnete können unter Umständen gewisse medizinische Geräte oder elektronische Systeme beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass der Magnet (bzw. der mit dem Magnet ausgestattete Telefonhörer) mindestens 30 cm von Kreditkarten, Floppy Disks und anderen magnetisch empfindlichen Geräten entfernt ist. Hörsystemträger und Personen mit implantiertem Herzschrittmacher werden gebeten, die Sicherheitshinweise der jeweiligen Geräte zu beachten.

Achtung

Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente beachten! Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden.

Hinweis des Herstellers

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie EMV-RL 2004/108/EG in der letztgültigen Fassung.Hierfür trägt das Gerät die CE-Kennzeichnung. Bitte bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf!

Type: D-BZ-EE-HS3, Version: 1.1/0913

Handhörer Modul EE-HS3 für EE 380ACS

Anschluss

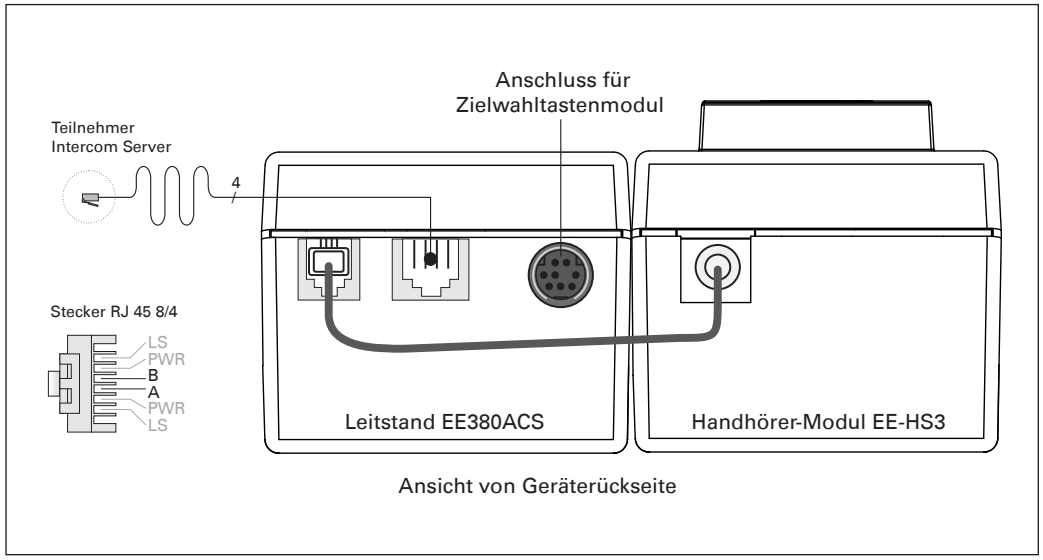

Ansicht von Geräterückseite

Systemanforderungen

- GE 800 / GE 300
- Digitale Teilnehmerkarte G8-GED / G3-GED
- Vollständiger Funktionsumfang (Plug&Play und erweiterte Handhörerfunktionalität) benötigt Leitstand EE 380ACS Rev. AC
- Intercom Server Software min. PRO 800 3.1
- Feature Lizenz 3.x

Achtung

Die im Handhörer EE-HS3 enthaltenen Magnete können unter Umständen gewisse medizinische Geräte oder elektronische Systeme beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass der Magnet (bzw. der mit dem Magnet ausgestattete Telefonhörer) mindestens 30 cm von Kreditkarten, Floppy Disks und anderen magnetisch empfindlichen Geräten entfernt ist. Hörsystemträger und Personen mit implantiertem Herzschrittmacher werden gebeten, die Sicherheitshinweise der jeweiligen Geräte zu beachten.

Achtung

Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente beachten! Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden.

Hinweis des Herstellers

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie EMV-RL 2004/108/EG in der letztgültigen Fassung.Hierfür trägt das Gerät die CE-Kennzeichnung. Bitte bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf!

Type: D-BZ-EE-HS3, Version: 1.1/0913

Handset Module EE-HS3 for EE 380ACS

Connection

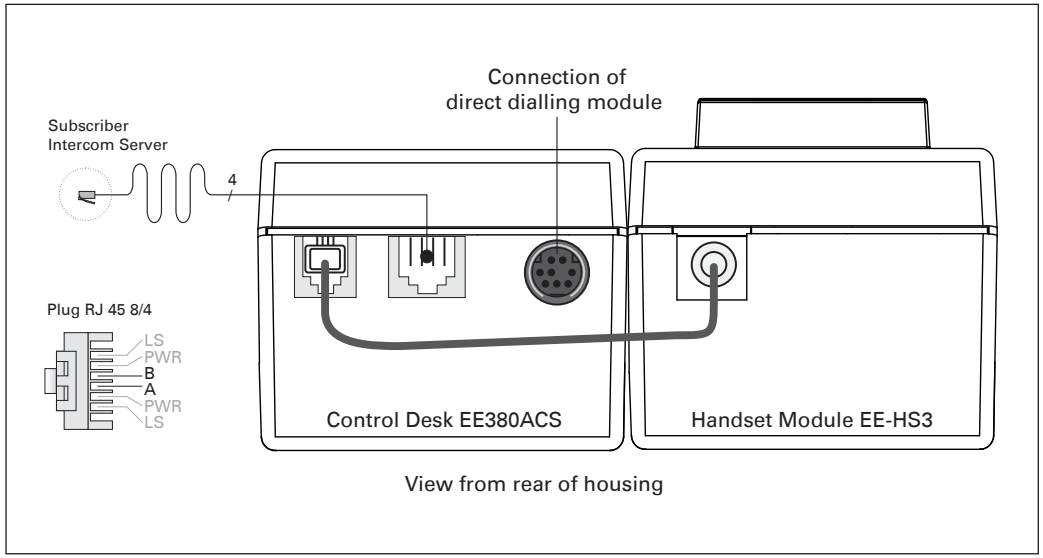

System requirements

- GE 800 / GE 300
- Digital subscriber card G8-GED / G3-GED
- Full scope of function (Plug&Play and extended handset function) requires EE 380ACS Rev. AC
- Intercom Server software min. PRO 800 3.1
- Feature licence 3.x

Attention

The magnets contained in the handset EE-HS3 can affect operation of certain medical devices and electronic systems under certain circumstances.
Please insure that the magnet (and the handset containing the magnet) keep at least 30 cm (11.8 in) distance to credit cards, floppy discs and any other magnetically sensitive devices.
For people carrying hearing aids or pacemakers, please pay
attention to the safety warnings of these devices.

Attention

Observe the precautions for handling of electrostatic sensitive devices!
The device may be only installed by authorised engineers.

Manufacturer's reference

This equipment fulfils the requirements of the EU standard EMV-RL 2004/108/EG in the current version. Therefore this equipment is CE-labelled.
Please keep this description in safe custody!

Type: D-BZ-EE-HS3, Version: 1.1/0913

Handset Module EE-HS3 for EE 380ACS

Connection

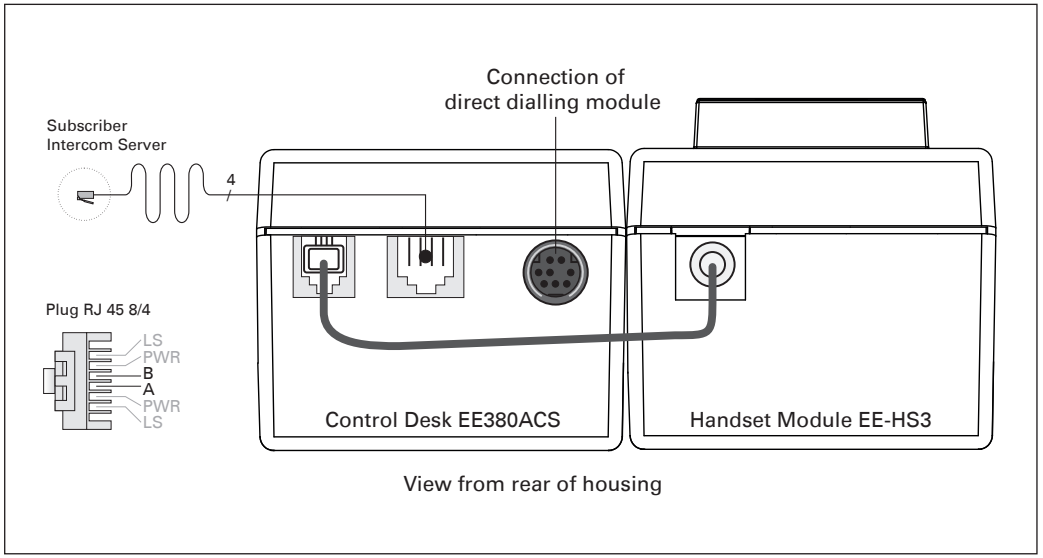

System requirements

- GE 800 / GE 300
- Digital subscriber card G8-GED / G3-GED
- Full scope of function (Plug&Play and extended handset function) requires EE 380ACS Rev. AC
- Intercom Server software min. PRO 800 3.1
- Feature licence 3.x

Attention

The magnets contained in the handset EE-HS3 can affect operation of certain medical devices and electronic systems under certain circumstances.
Please insure that the magnet (and the handset containing the magnet) keep at least 30 cm (11.8 in) distance to credit cards, floppy discs and any other magnetically sensitive devices.
For people carrying hearing aids or pacemakers, please pay
attention to the safety warnings of these devices.

Attention

Observe the precautions for handling of electrostatic sensitive devices!
The device may be only installed by authorised engineers.

Manufacturer's reference

This equipment fulfils the requirements of the EU standard EMV-RL 2004/108/EG in the current version. Therefore this equipment is CE-labelled.
Please keep this description in safe custody!

Type: D-BZ-EE-HS3, Version: 1.1/0913